


一次性使用结扎装置 (HX-400U-30)

快速参考指南

注意:本指南仅为HX-400U-30 PolyLoop的使用说明摘要。请务必遵循随产品附带的奥林巴斯内镜治疗PolyLoop HX-400U-30的使用说明书。

部件名称




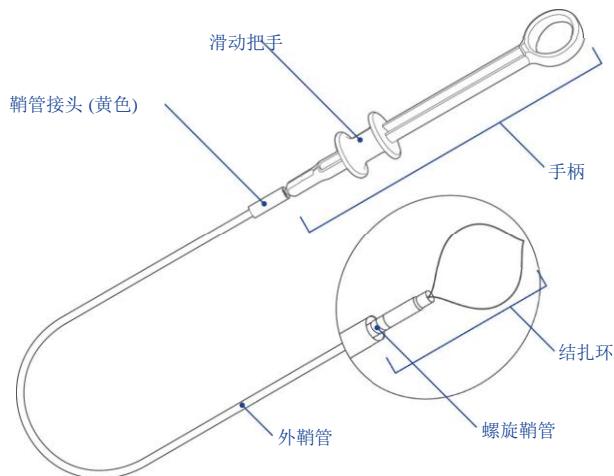


准备

- 向前推动鞘管接头，将结扎环收回外鞘管。 将本器械小心地插入钳子管道开口阀。


操作

- 拉动鞘管接头至触至手柄，从外鞘管中伸出结扎环。

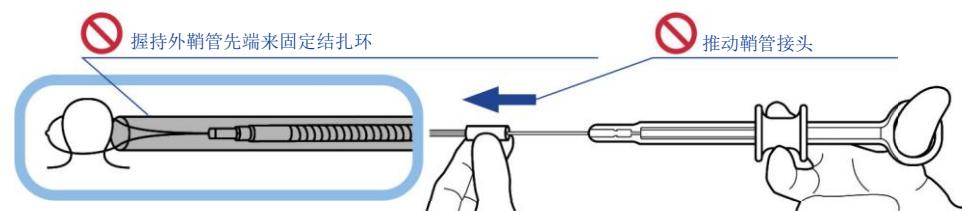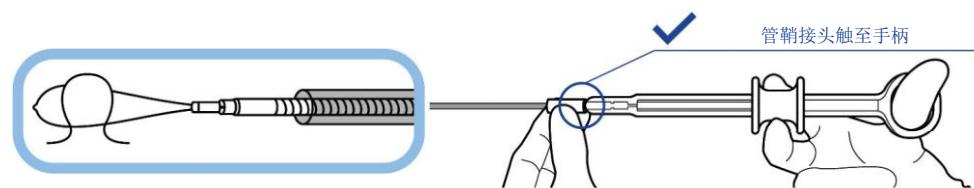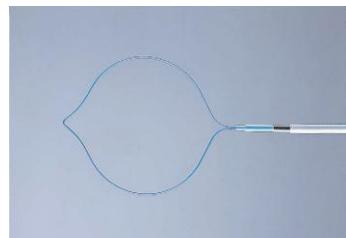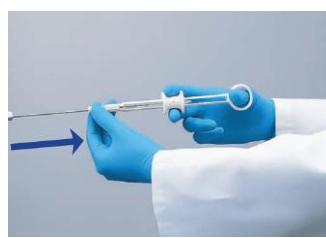

3. 将打开的结扎环套在组织上。拉动滑动把手，结扎目标组织。




注意: 结扎手术过程中，请勿过度用力操作结扎环

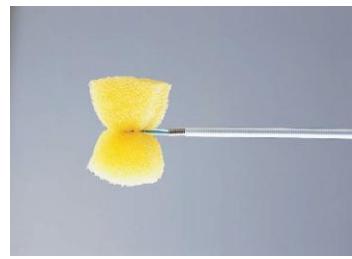

4. 推动滑动把手到头，从螺旋鞘管中伸出挂钩。从挂钩上分离结扎环。

注意: 螺旋鞘管未伸出外鞘管时，请勿将结扎环从挂钩上移除。

注意: 请确保外鞘管近端抵住手柄，并与内镜钳子管道开口阀保持伸直。

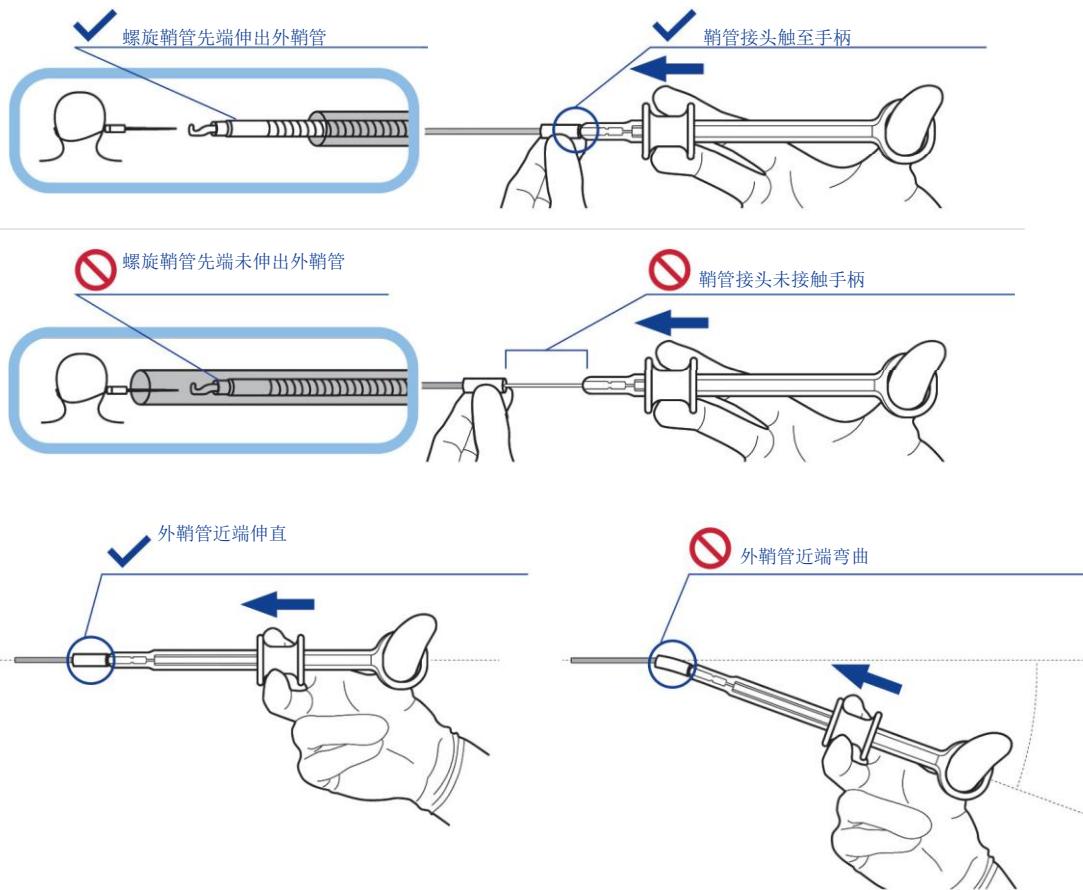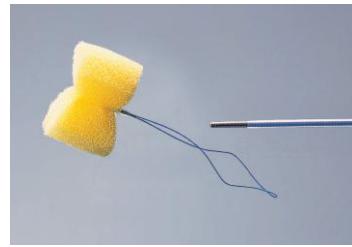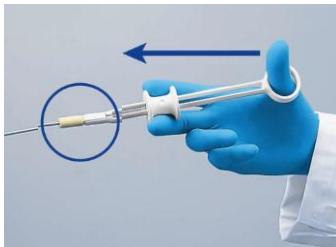

参考:

务必准备好奥林巴斯结扎线剪刀、钳子或切断用具，以便结扎环不能从器械上分离时切断螺旋鞘管、外鞘管和操作丝。




紧急处理


如果结扎环不能从本器械上分离，请按照本节所述步骤进行处理。

1. ·伸直露在患者体外的内镜部分。

·伸直本器械露在钳子管道开口阀外的部分

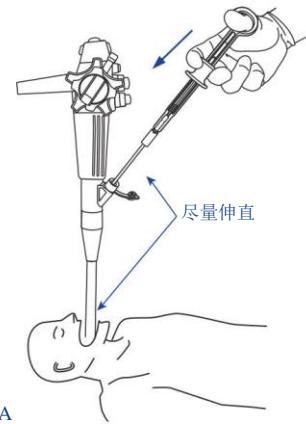


·推动滑动把手到头，从螺旋鞘管中伸出挂钩

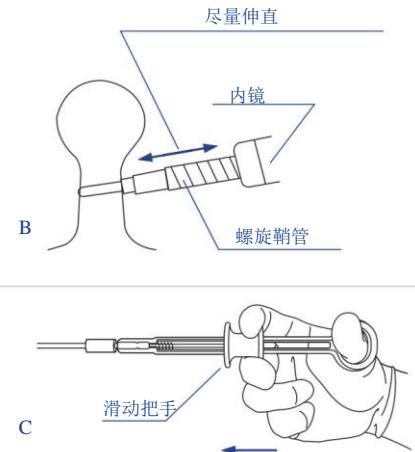

2. ·用钳子或其它切断用具将外鞘管、螺旋鞘管和操作丝切断。

·抽出内镜。

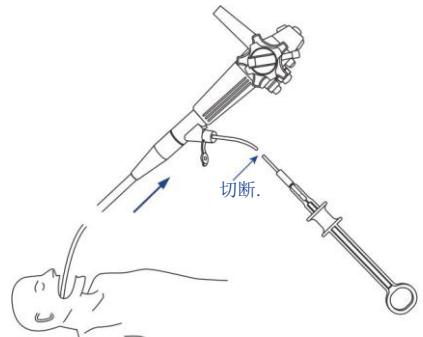


3. 当螺旋鞘管的先端不靠近结扎环卡锁时

·沿外鞘管再次插入内镜。

·用结扎线剪刀切断结扎环。

·将外鞘管、螺旋鞘管和操作丝一起抽出。



当螺旋鞘管的先端靠近结扎环卡锁时

·将结扎环留在原处，直到组织坏死，结扎环和组织脱落。这需要一段时间。

·实施外科手术或其它可行的治疗措施。